


DATABLAD A1 TILBEHØR



A2 SGS Til indstilling af output på gnisttestere ST-AC 100 , C200K Mk5 og PPM Mk3 (anbefales ikke til brug sammen med TMF gnisttester).

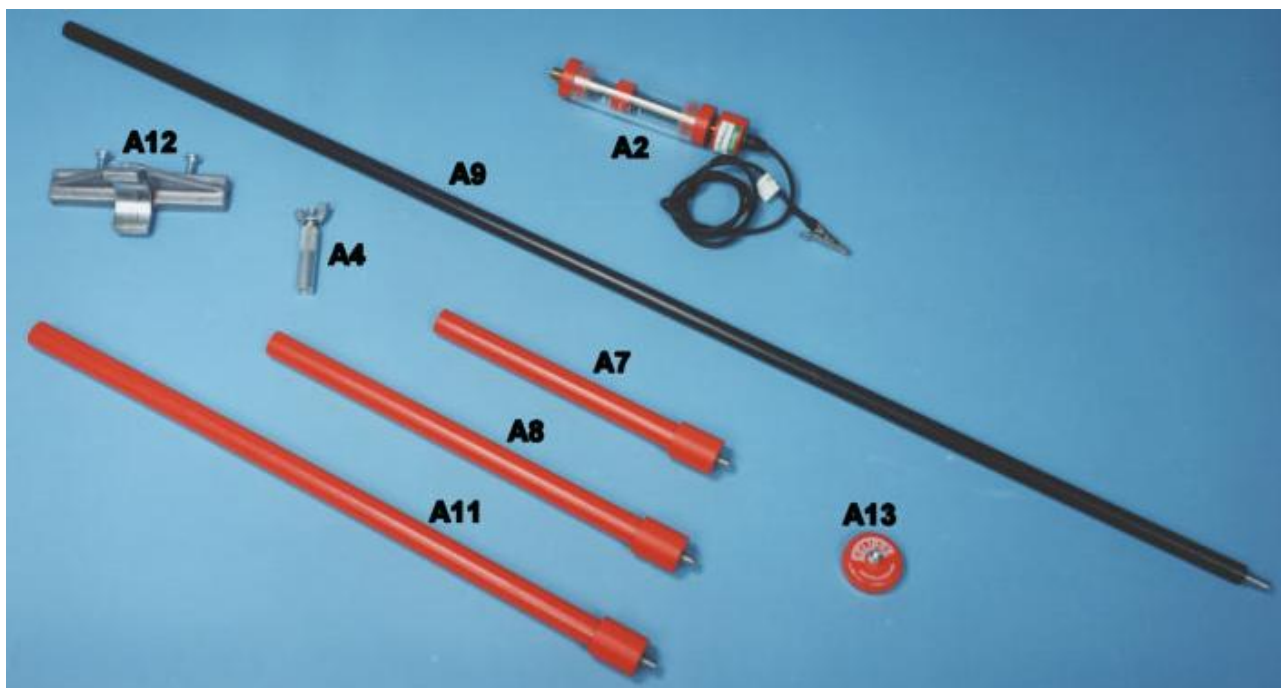

A4 Adapter. For tilslutning lige Bronze elektroder (E104 – E124) eller lige Silikone elektroder (E204 – E224) direkte til test håndtag



Isolerede forlænger stænger. A7 220 mm. – A8 330 mm. – A11 460 mm. – A9 1000 mm.



A12 Sko tilslutning. Tilslutter Rolling Spring elektroder (E704 – E748)



A13 Magnet
Til jordforbindelse på glatte overflader.

Grundet den almindelige tekniske udvikling kan ovenstående data ændres uden varsel.